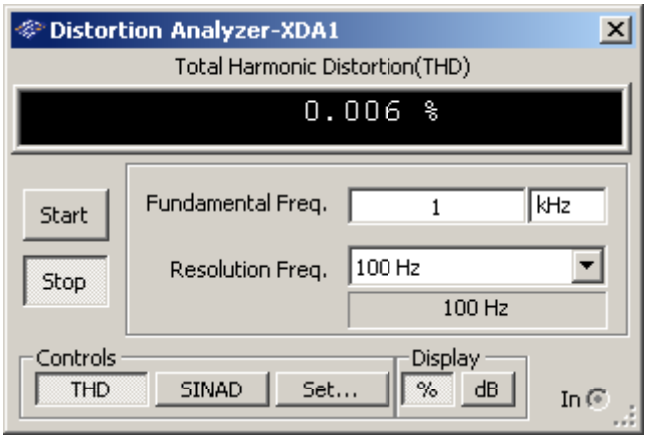
Distortion Analyzer-XDA1
Total Harmonic Distortion(THD)
0.006 %
Start
Stop
Fundamental Freq.
1
kHz
Resolution Freq.
100 Hz
100 Hz
Controls
THD
SINAD
Set...
Display
%
dB
In

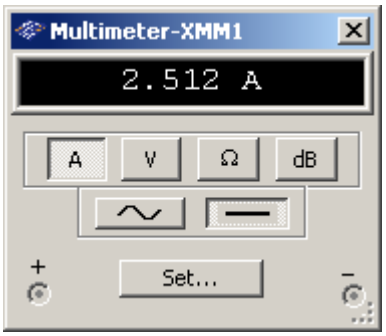
Multimeter-XMM1
2.512 A
A
V
Ω
dB
Set...

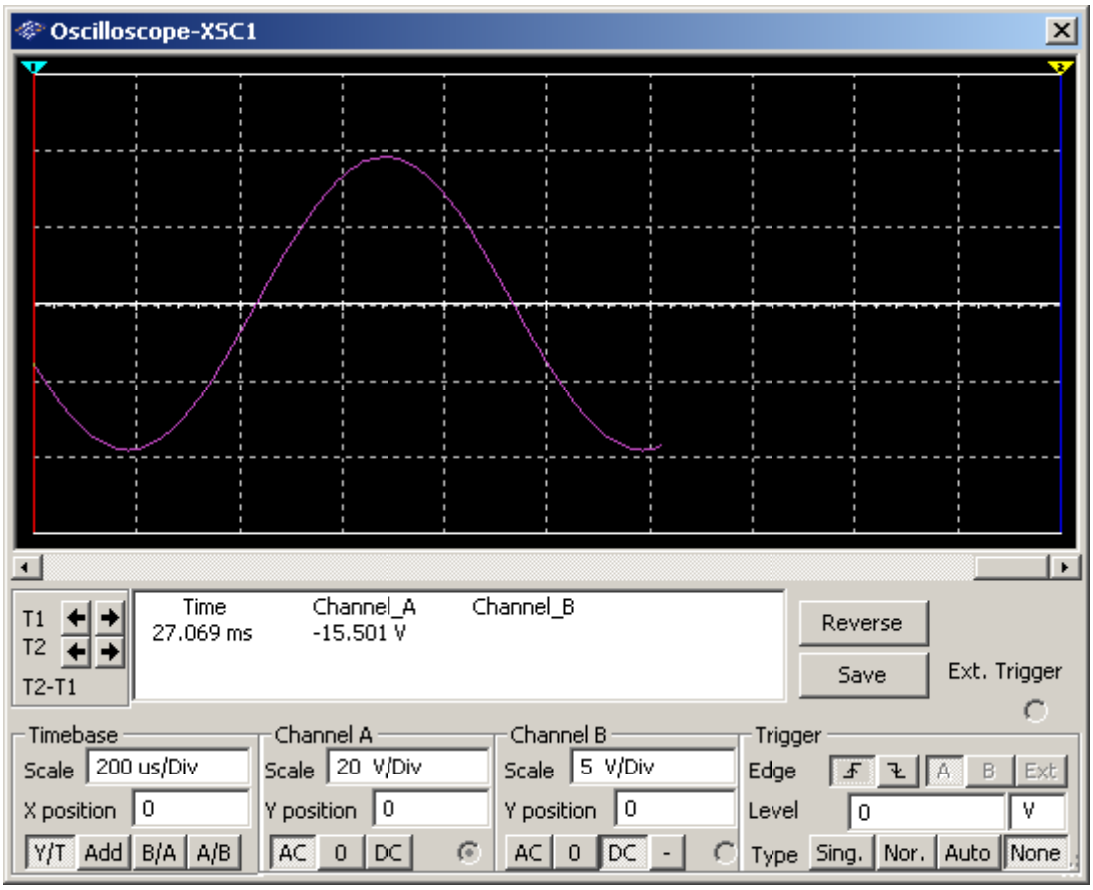
Oscilloscope-XSC1
T1
T2
T2-T1
Time
27.069 ms
Channel_A
-15.501 V
Channel_B
Reverse
Save
Ext. Trigger
Timebase
Scale
200 us/Div
X position
0
Y/T
Add
B/A
A/B
Channel A
Scale
20 V/Div
Y position
0
AC
0
DC
Channel B
Scale
5 V/Div
Y position
0
AC
0
DC
-
Trigger
Edge
A
B
Ext
Level
0
V
Type
Sing.
Nor.
Auto
None